

Instrumentes de contrôle pour l'assurance de la qualité

Jauges de contrôle


Ces jauges de contrôle sont le service simple pour contrôler l'ajustement des bouchons fermés (diamètre de sertissage)

Car: fermé avec un diamètre de sertissage insuffisant les bouchons commence à couler, tandis qu'un sertissage trop serré met en danger les bouches des bouteilles en verre et les rends difficiles à ouvrir.


- le Ø du petit jauge **ne doit pas** superposé les dents des bouchons fermés.
- le Ø du large jauge **doit** superposé les dents des bouchons fermés

Dimensions des jauges en mm pour bouches de bouteille standard

art. no.	purpose	petit Ø mm	large Ø mm
87	Ø 26 mm bouchons couronne fermés (embouteillage froide)	28.35	28.85
89	Ø 26 mm bouchons couronne fermés (pasteurisation / stérilisation) bouchons couronne à vis fermés	28.55	28.75
88	Ø 29 mm bouchons couronne fermés (embouteillage froide)	31.20	31.70
88.1	Ø 29 mm bouchons couronne fermés (vins mousseux / embouteillage froide / pasteurisation)	31.20	31.40

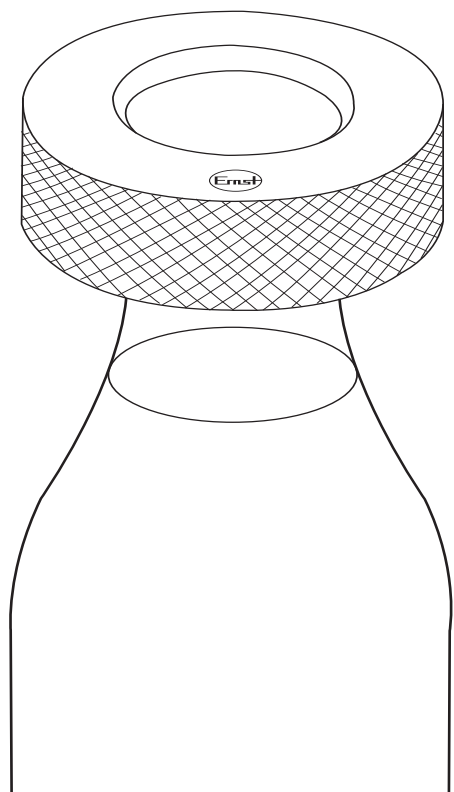

petit jauge Ø

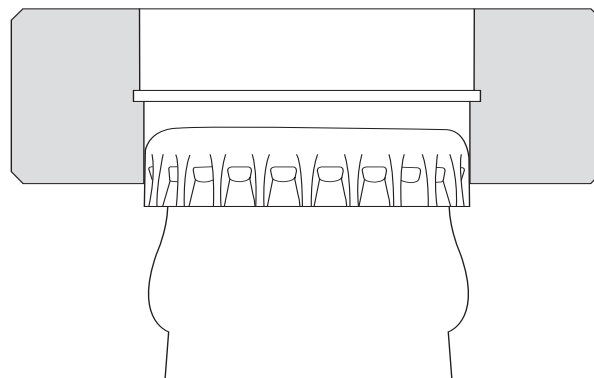

large jauge Ø

